


Руководитель (заместитель руководителя)

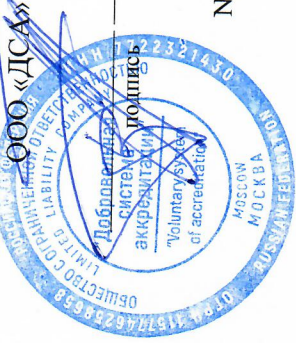

А.Д. Пендюрин

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату

N 10 от 19 марта 2026 г.

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации

Испытательного центра ООО «Акзо Нобель Коутингс»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица


141441, Московская обл., г.о. Химки, д. Елино, ул. Летняя, 8С

Адрес(а) места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33120 п.9	Клеевая деревянная конструкция	20.30.13.310	4418991000	Предел прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе	(0-50) МПа
2	ГОСТ 33120 п.7	Клеевая деревянная конструкция	20.30.13.310	4418991000	Предел прочности клеевого соединения при послойном скалывании вдоль волокон древесины	(0-30) МПа
3	ГОСТ 33121 п.10	Клеевая деревянная конструкция	20.30.13.310	4418991000	Стойкость клеевых соединений к расслаиванию	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
4	ГОСТ 33122 (приложение Г)	Клей для древесины	20.52.10.120	3506990000	Водородный показатель pH	(0-14)
5	ГОСТ 33122 (приложение Д)	Клей для древесины	20.52.10.120	3506990000	Динамическая вязкость	(15-100 000) мПа*с

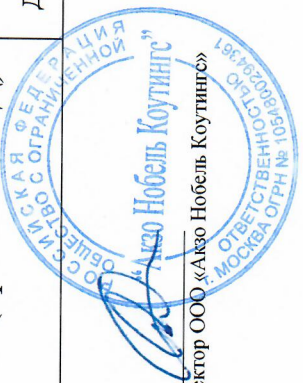

Соболь Н.В.

Генеральный Директор ООО «Акзо Нобель Коутингс»

_____ подписать _____ инициалы, фамилия

Малютина А.А.

Руководитель лаборатории

_____ подписать _____ инициалы, фамилия